CAT-221_(FR) V02 03/2023

bti
Human
Technology

Séquences de forage recommandées

pour implants BTI Externa

REMARQUE : Veuillez consulter la disponibilité du produit sur les différents marchés auprès de chaque distributeur.

Marques de profondeur de forage

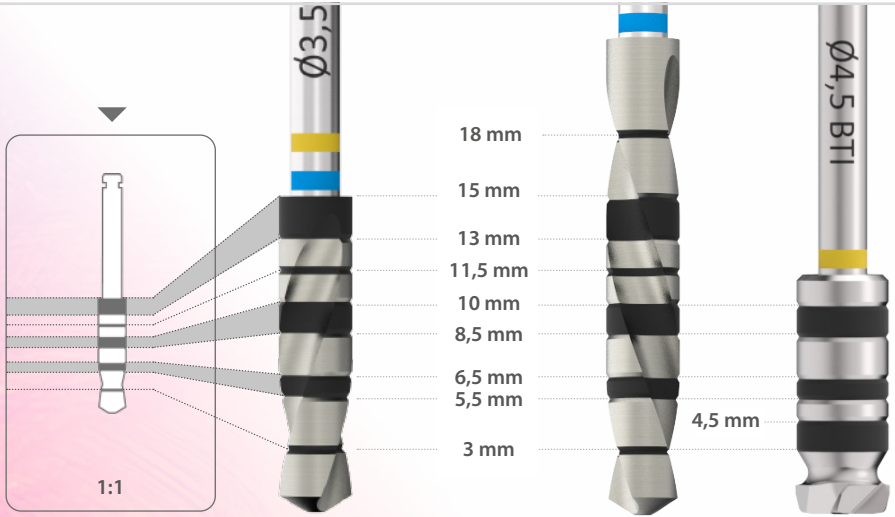

Type/Hounsfield

I	1050 - 1400	III	550 - 800
II	850 - 1000	IV	400 - 500
		V	100 - 350

FORET	VITESSE	IRRIGATION
Foret de démarrage	800 - 1.000 rpm	oui
Forets	50 - 75 rpm	non
Fraises cuvette	150 - 200 rpm	non
Foret coupe frontale	50 - 75 rpm	non

Implants de longueur

(de 10 à 15 mm)

Longueur totale de l'implant
75 % de longueur totale de l'implant
25 % de longueur totale de l'implant
5,0 mm de profondeur de forage

3,5 Ø	TYPE OSSEUX	DÉMARRAGE	Ø 1,8 mm	PILOTE	Ø 2,5 mm	INFAPUC INFAPUL	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	
2,5 Ø	II	■	■							2
	0-I	■	■							2
3,0 Ø	II	■	■							2
	0-I	■	■	▬						3
3,3 Ø	III	■		■						2
	II	■		■	■					3
	0-I	■		■	■		▬			4
3,5 Ø	III	■		■						2
	II	■		■			■			3
	0-I	■		■			■	▬		4
3,75 Ø	IV-V	■		■						2
	III	■		■		▪	■			4
	II	■		■		▪	■	■		5
	0-I	■		■		▪	■	■	▬	6

Plateforme Tiny

Ø3,5 mm diamètre de plateforme

Séquences de forage

bti Human Technology

Implants de longueur

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

Longueur totale de l'implant

X,X Ø *Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié*

5 mm de profondeur de forage
(Ne pas utiliser avec la longueur 4,5 mm)

3,5 Ø	TYPE OSSEUX	DÉMARRAGE	Ø 1,8 mm	PILOTE	Ø 2,5 mm	INFAPUC INFAPUL	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	COUPE FRONTALE	
2,5 Ø	II	▬	▬								2
	0-I	▬	▬								2
3,0 Ø	II	▬	▬								2
	0-I	▬	▬	▬							3
3,3 Ø	III	▬		▬							2
	II	▬		▬	▬						3
	0-I	▬		▬	▬		▬			3,0 Ø	5
3,5 Ø	III	▬		▬							2
	II	▬		▬			▬			3,0 Ø	4
	0-I	▬		▬			▬	▬		3,0 Ø	5
3,75 Ø	IV-V	▬		▬							2
	III	▬		▬		▬	▬			3,0 Ø	5
	II	▬		▬		▬	▬	▬		3,0 Ø	6
	0-I	▬		▬		▬	▬	▬	▬	3,5 Ø	7

Plateforme Tiny

Ø3,5 mm diamètre de plateforme

Séquences de forage

bti Human Technology

Implants de longueur
(de 10 à 15 mm)

Longueur totale de l'implant
75 % de longueur totale de l'implant
25 % de longueur totale de l'implant
5,0 mm de profondeur de forage

Plateforme Universelle

Ø4.1 mm diamètre de plateforme

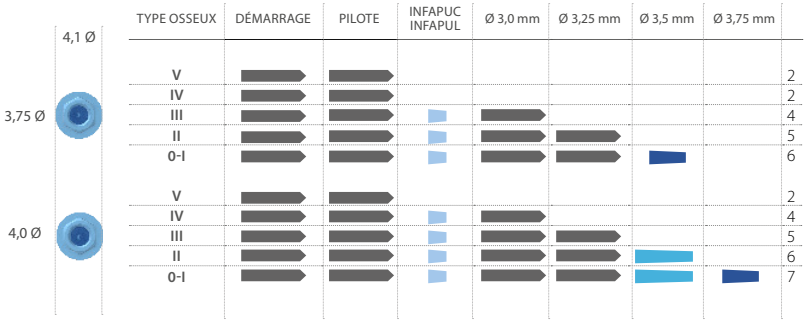

Séquences de forage

bti Human Technology

Implants de longueur

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

Longueur totale de l'implant

X,X Ø *Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié*

5,0 mm de profondeur de forage

2-3 mm de profondeur de forage

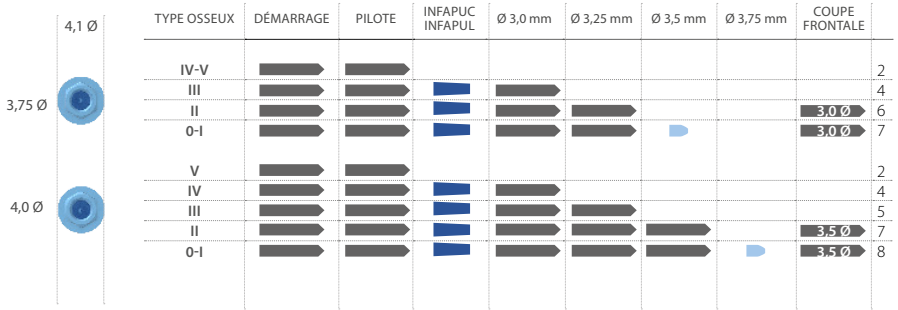

Plateforme Universelle

Ø4.1 mm diamètre de plateforme

Séquences de forage

bti Human Technology

Implants de longueur
(de 10 à 15 mm)

Longueur totale de l'implant
75 % de longueur totale de l'implant
25 % de longueur totale de l'implant
4,5 mm de profondeur de forage

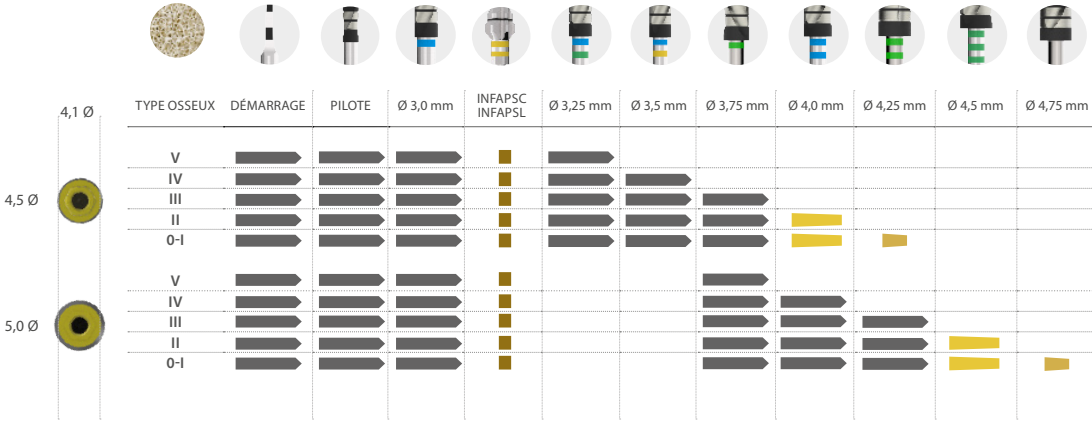

Séquences de forage

Human Technology

Plateforme **Universelle Plus**

Ø4.1 mm diamètre de plateforme

Implants de longueur

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

Longueur totale de l'implant

X,X Ø *Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié*

4,5 mm de profondeur de forage

	TYPE OSSEUX	DÉMARRAGE	PILOTE	Ø 3,0 mm	INFAPSC INFAPSL	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,25 mm	Ø 4,5 mm	COUPE FRONTALE	Ø 4,75mm	
4,1 Ø	V	■	■	■	■	■								5
	IV	■	■	■	■	■	■					3,5 Ø		7
4,5 Ø	III	■	■	■	■	■	■	■				3,5 Ø		8
	II	■	■	■	■	■	■	■	■			4,0 Ø		9
	0-I	■	■	■	■	■	■	■	■	■		4,0 Ø		10
	V	■	■	■	■			■				3,5 Ø		6
	IV	■	■	■	■			■	■			4,0 Ø		7
5,0 Ø	III	■	■	■	■			■	■	■		4,0 Ø		8
	II	■	■	■	■			■	■	■	■	4,5 Ø		9
	0-I	■	■	■	■			■	■	■	■	4,5 Ø	■	10

Séquences de forage

bti Human Technology